メディシンボックス取扱説明書

DD19SXS・SXZ/DD20SXS・SXZ

●本説明書は取付後も廃棄せずご使用者にお渡しください。

安全上の注意（必ずお守りください）

設置工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく設置してください。
■施工を誤った場合、使用者に生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

⚠警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。	⚠注意 この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合または物的損害のみの発生が想定される」内容です。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

この図記号は、してはいけない「禁止」の内容です。	この図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠ 取付けに関する警告

- 壁面の固定ねじ取付箇所は、必ず下地を補強してください。落下し、ケガをする恐れがあります。
- 取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。固定が不完全な場合、製品のガタツキ、壁との隙間、落下等の原因となります。

⚠ 取付けに関する注意

- ガラスや棚に無理な力や強い衝撃を与えないで下さい。破損するおそれがあります。
- ALC材・軽鉄・コンクリートブロックなどの中空部には取付けできません。
- 屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。部品などが腐食して、破損や落下等の原因となります。

⚠ ご使用に関する警告

- 本製品の棚の耐荷重は19.6N(2kgf)です。それ以上の荷重を加えますと破損してケガをするおそれがあります。
- 本製品（DD20）のタオルハンガー部分の耐荷重は98N(10kgf)です。それ以上の荷重を加えますと破損してケガをするおそれがあります。
- 用途以外のご使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。

⚠ ご使用に関する注意

- 化粧品が付着しない様にしてください。付着した場合はすぐに、完全に拭き取ってください。プラスチックが劣化して、破損や落下等の原因となります。
- お手入れは柔らかい布で水拭きしてください。汚れがひどい時は薄めた中性洗剤を含んだ布で拭き取った後、水拭きして下さい。ベンジン、シンナー、アルコール、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。

取付前の準備

下地取付例

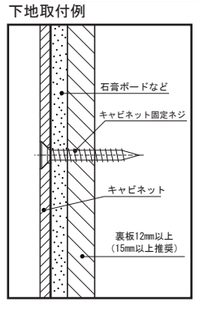

製品寸法及び下地加工位置

- ●取付は必ず平滑な壁面としてください。(取付が不充分になり、落下してケガや重大事故につながる恐れがあります。) ⚠警告
- ●下地には必ず、指定の厚みの裏板もしくは桟木を入れ、補強してください。(補強が弱いと、落下してケガや重大事故につながる恐れがあります。) ⚠警告
- ●取付は必ず、付属の固定ネジ、バネ座金を使用してください。(取付が不充分になり、落下してケガや重大事故につながる恐れがあります。) ⚠警告

製品寸法

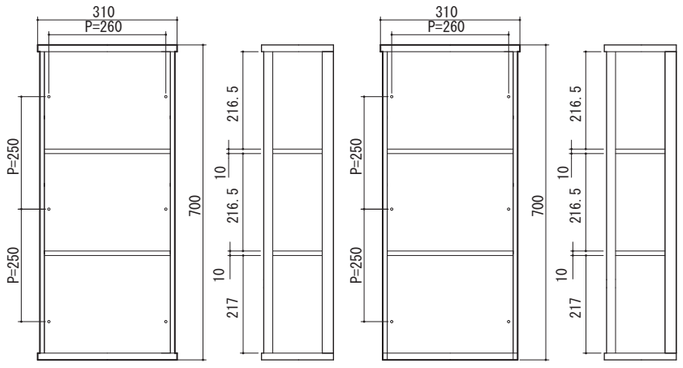

DD19　　DD20

取付手順

①取り付け位置を決め、キャビネットをキャビネット固定ネジにて、平らな壁面に確実に固定して下さい。
※ネジを完全に閉めこむ前にキャビネットの傾きを調整してください。
②背面ミラーをキャビネットにマジックテープにてしっかり固定します。
※ミラーを取り外す際は吸盤等利用して下さい。隙間をドライバー等でこじ開けるとガラスが破損するおそれがありますのでおやめ下さい。 ⚠警告

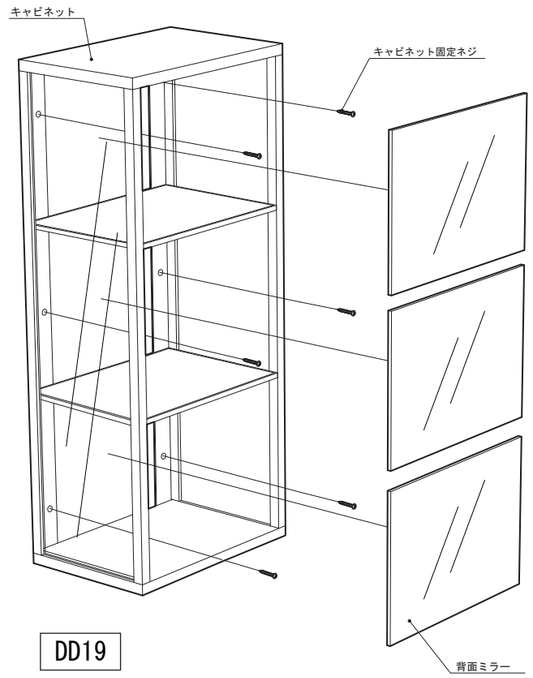

DD19

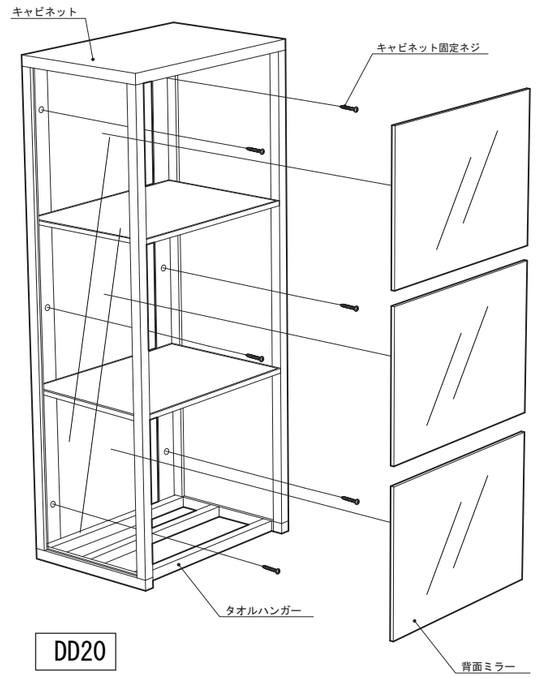

DD20

メンテナンス

●取付の失敗や設置場所の移動、破損等でミラーを取外す時は、吸盤、ガムテープ等を使い、ゆっくり裏面のマジックテープを剥がし取外して下さい。 ⚠注意
その時、ミラーを破損させないように気をつけて丁寧に剥がしてください。

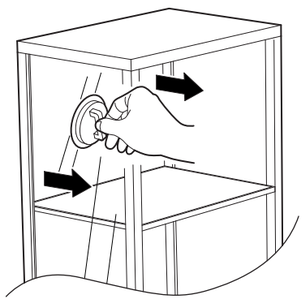

施工時には養生シートを剥がさないで下さい。
傷防止の為、お客様引渡し前に剥がしてください。

KAWAJUN
www.kawajun.co.jp
NO.006